



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>

Usuário: Jaciara Talita

Chave de Autenticação Digital
1887-7180-321

Página
1 / 1

Solicitação de Compra/Contratação

Número: 435/2021

Emissão: 22/02/2021

Situação: Liberada

Órgão Orçam.: 21000 - Fundo Municipal de Saúde de Chapecó - FMS

Un. Orçam.: 21021 - Fundo Municipal de Saúde de Chapecó - FMS

Centro de custo: 0002.0001.0051 - UPA

Descrição: COVID 19 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 5 BOMBAS DE INFUSÃO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

Despesa		Despesas	Valor indicado (R\$)	Valor bloqueado (R\$)
397 - 2. 21021 - 10 - 301 - 107 - 2.605 - 0 - 449000 - Aplicações Diretas		Fonte de recurso 3380 - Superávit - 38 Transferências do Sist Unico de Saúde	39.750,00	0,00

Itens			Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Item 1	Quantidade 5,00000 UNIDADE	Material/Serviço 191194 - BOMBA DE INFUSÃO	7.950,00000	39.750,00

Complemento do item: Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear, marca SAMTRONIC, modelo icatu, de fabricação nacional, para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável. Utiliza descartável micro e macrogotas destinados a serem utilizados em bombas de infusão que estejam de acordo com as seguintes características: tubo de PVC de diâmetro interno 3,1mm e diâmetro externo 4,2mm e dureza entre 65 a 70 Shore A. Sistema de propulsão peristáltico linear. Desvio da vazão com equipo padrão de \pm 5% da vazão programada (típico). Possui cinco tipos de programação de infusão: mL/h x volume limite, tempo x volume limite, peso x concentração x dose (com opção de programação do bolus por volume ou por dose), vazão e sequencial. Vazão de 0,1 a 1200,0 mL/h programável a intervalos de 0,1 mL/h e controle de volume a infundir de 0,1 a 9999,9 mL. Peso corpóreo máximo 500,0 kg. Limite de concentração de droga: 0,01 a 999,99 mg/mL ou 0,01 a 999,99 g/mL. Limite de dose de manutenção: 0,01 a 999,99 mg/kg/min ou 0,01 a 999,99 g/kg/min. Limite de dose inicial: 0,01 a 999,99 g/kg/min ou 0,01 a 999,99 mg/kg/min. Taxa de KVO ajustável de 0,0 (desabilitado) a 10,0 mL/h. Vazão de Bolus ajustável de 0,2 a 1200,0 mL/h e Volume do Bolus ajustável de 0,5 a 40,0 mL. Possui as seguintes funções: Ajuste de data e hora, macro e micro gotas, volume sonoro, bloqueio de teclado, dados da infusão anterior, ajuste de display, senha do operador, biblioteca de drogas (179 drogas cadastradas e possibilidade de acrescentar 30 drogas CUSTOM), balanço hídrico, ajuste de oclusão, ajuste do sensor de gotas, ajuste do sensor de ar, pré-alarmede fim de infusão com tempo ajustável, ajuste do bolus, ajuste do KVO, ajuste do volume de purga, modo transporte, titulação, reconhecer alarmes, reinicialização de alarmes, zerar volume e programação do volume do frasco. Display com apresentação constante da vazão, barra de progresso da infusão, volume infundido, volume restante (VTBI), tempo restante da infusão, indicador de hora, indicador gráfico de carga da bateria, indicador gráfico de gotejamento real, indicador gráfico e numérico da pressão atual e indicador gráfico de bloqueio de teclado. Possui teclas virtuais com funções rápidas que se alternam de acordo com a necessidade da etapa de programação/infusão. Conta com a opção *Detalhes* durante a infusão para visualização de todas as informações sobre a programação realizada, volume total infundido e os 4 últimos volumes parciais infundidos em todos os modos de programação. Possui sensor de ar na linha ultrassônico ajustável desde alarme imediato para detecção de qualquer bolha de ar, até 500 ?L e sensor de pressão ajustável em três níveis: Alto (100 kPa), Médio (60 kPa) e Baixo (30 kPa). Pré-alarmes: fim da bateria, fim da dose inicial (indução), fim da infusão e fim do volume de frasco. Alarmes visuais e sonoros: espera (stand by), vazão livre, KVO, infusão interrompida, oclusão, ar na linha, porta aberta, frasco vazio, infusão completa, bateria baixa, bateria crítica, erro de programação (valor inválido), sentido do fluxo, desconectar paciente, bomba sem equipo, modo transporte (sensor de gotas desabilitado) e sensor de ar desligado. O limite de armazenamento de registros da bomba icatu (ICATU 3a edição) é de 8.000 eventos, incluindo registros técnicos e de infusão (a quantidade de infusões gravadas varia com a quantidade de eventos utilizados). A bomba vem com bateria recarregável de níquel-metal hidreto de longa vida com autonomia de até 5 horas, cabo de alimentação e manual do usuário no idioma Português. Este modelo possibilita o download dos dados de infusão pelo software SamLOG II através de comunicação por uma porta USB (conectividade) (opcional). Opcionalmente poderá ser fornecida uma haste para soro. Equipamento de pequeno porte, leve, com design inovador e teclado capacitivo de fácil manuseio e limpeza.

Total geral (R\$)

39.750,00

Valdecir José Miotto

Diretor de Administração, Finanças e Infraestrutura

LUIZ CARLOS BALSAN

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ordenador de despesa

(10419) Hominum Comércio e Rep. LTDA

**Memorando 11.080/2021**

Responder apenas via 1Doc

PREFEITURA DE
CHAPECÓ

Leandra P. 24ATES

Para

01DAFI - Diretor...

CC

04DTEC - Diretoria Técnica

UPA 24h - Unidade de Pronto Atendimento

01DAFI - Diretoria de Administração

Finanças e Infraestrutura

6 setores envolvidos

24ATES

01DAFI

04DTEC

UPA 24h

FMS-COMP

17DGC

18/02/2021 10:23

Bombas de infusão - URGENTE - UPA

Bom dia Valdecir,

Considerando que os pacientes com suspeita ou confirmados COVID-19 estão permanecendo em observação na UPA por longo período;

Considerando o aumento da demanda de infusão de medicação por via endovenosa.

Solicito com **URGÊNCIA** compra ou comodato de **10 unidades de BOMBAS DE INFUSÃO**, bem como:

- Equipos correspondentes a marca/modelo (incluindo dos tipos simples e fotossensível);
- Garantia e assistência técnica.

Atenciosamente,

—
Leandra Oliveira Porto

Enfermeira – COREN-SC 393.292

Gerente de Atenção Especializada

(49) 3319-1415 | 99835-0957

Folha de rosto: contém documento físico

Quem já visualizou? 8 pessoas

Visto 38 vezes

18/02/2021 11:03:03

Rafaela Gomes Cortina 04DTEC arquivou.

**Despacho 1-
11.080/2021**

18/02/2021 11:21

(Encaminhado)

Jacira!

bom-dia

Atualizar aqui as cotações feitas e os retornos.

Valdecir M. 01DAFI

FMS-COMP - Compr...

—
Valdecir José Miotto

Diretor de Infraestrutura e Finanças

CC

Quem já visualizou? 8 pessoas

**Despacho 2-
11.080/2021**

18/02/2021 11:34

(Respondido)

Jacira S. **FMS-COMP****01DAFI - Diretor...**

CC

Prezados, segue primeiras informações.

Altermed: prazo mínimo de entrega 20 a 30 dias. R\$ 7.999,00 cada.

BL Florianópolis/Guido: não há disponibilidade imediata e nem prazo para entrega previsto.

Aguardando retorno da BR CIRÚRGICA, Pró-cirúrgica e Cirúrgica SC.

—
Jaciara T. Scheren*Técnica em Administração*

Quem já visualizou? 8 pessoas

**Despacho 3-
11.080/2021**

18/02/2021 12:51

(Encaminhado)

Valdecir M. **01DAFI****17DGC - Diretori...***A/C Riquelmo B.*

CC

Boa tarde

Para apoio.

—
Valdecir José Miotto*Diretor de Infraestrutura e Finanças*

Quem já visualizou? 8 pessoas

18/02/2021 13:51:56

Rafaela Gomes Cortina **04DTEC** arquivou.**Despacho 4-
11.080/2021**

18/02/2021 14:42

(Respondido)

Jacira S. **FMS-COMP****04DTEC - Diretor...**

CC

Segue nova informação;

Pró-cirúrgica: Entrega até 7 dias após confirmação do pedido: R\$ 10.350,00 cada.

—
Jaciara T. Scheren*Técnica em Administração*

Quem já visualizou? 7 pessoas

**Despacho 5-
11.080/2021**

18/02/2021 15:27

(Respondido)

Jaciara S. FMS-COMPFMS-COMP - Compr...

CC

Segue nova informação:

Hominum: R\$ 7.950,00, entrega em até 10 dias segundo orçamento (até sexta-feira segundo informação da vendedora).

—
Jaciara T. Scheren
Técnica em Administração

Quem já visualizou? 7 pessoas

18/02/2021 15:53:03

Rafaela Gomes Cortina 04DTEC arquivou.

18/02/2021 15:53:03

Rafaela Gomes Cortina 04DTEC parou de acompanhar.**Despacho 6-
11.080/2021**

19/02/2021 07:51

(Respondido)

Valdecir M. 01DAFIFMS-COMP - Compr...

CC

Bom dia

Incluir opção de comodato, com valores mensais por equipamento e prazo mínimo de contrato e entrega, para avaliarmos.

—
Valdecir José Miotto
Diretor de Infraestrutura e Finanças

Quem já visualizou? 3 pessoas**Despacho 7-
11.080/2021**

19/02/2021 09:50

(Respondido)

Valdecir M. 01DAFI24ATES - ATENÇÃO...A/C Leandra P.
CC

Leandra!

Bom-dia

As opções acima.

Da Hominum é a que entrega num prazo menor. As alternativas do fornecedor:

1 - Compra

r\$ 7.950,00 cada, se emitido empenho hoje entrega dia 26/02/2021

Valor do equipo r\$ 11,90 a r\$ 12,90

2 - Locação

r\$ 3.200,00/mes contrato mínimo de 12 meses, entrega dia 05/03/2021, se assinando contrato hoje

Valor do equipo r\$ 33,18 a r\$ 36,61

3 - Comodato

Consumo mínimo de 7 equipos por bomba/mes, valor aproximado de r\$ 2.500,00/mes - Contrato mínimo 12 meses, entrega em 05/03/2021 se assinado contrato hoje

Valor do equipo r\$ 33,18 a r\$ 36,61

O equipamento de venda é diferente do de locação, por isso valor diferente dos equipamentos.

Favor avaliar se seguimos com a compra devido ao prazo de entrega e as opções.

—
Valdecir José Miotto

Diretor de Infraestrutura e Finanças



Quem já visualizou? **3 pessoas**


Prefeitura Municipal de Chapecó - Av. Getúlio Vargas, 957S CEP 89812-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 22/02/2021 11:06:11 por Jaciara Talita Scheren - Técnico em Administração

"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento." - *Frederick Herzberg*

1Doc

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECÓ FMS DE CHAPECÓ	CNPJ:	80.636.475/0001-08
Endereço:	R Mal Floriano Peixoto,,700 - - 3o andar 89801-501 - Chapecó/SC (49) 33210090 gae@chapeco.sc.gov.br	IE:	
Contato:	JACIARA SCHEREN - RESPONSÁVEL COMPRAS 04933210057 - fincompras5@chapeco.sc.gov.br		


PRODUTOS OFERECIDOS:

Item	Quantidade	Descrição do Produto	Unitário	Desconto Un	Total
------	------------	----------------------	----------	-------------	-------

SAMTRONIC

1	10 UN	BOMBA DE INFUSÃO ICATU 3ED (EMPILHABEL) <i>Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear, marca SAMTRONIC, modelo icatu, de fabricação nacional, para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável. Utiliza descartável micro e macrogotas destinados a serem utilizados em bombas de infusão que estejam de acordo com as seguintes características: tubo de PVC de diâmetro interno 3,1mm e diâmetro externo 4,2mm e dureza entre 65 a 70 Shore A. Sistema de propulsão peristáltico linear. Desvio da vazão com equipo padrão de $\pm 5\%$ da vazão programada (típico). Possui cinco tipos de programação de infusão: mL/h x volume limite, tempo x volume limite, peso x concentração x dose (com opção de programação do bolus por volume ou por dose), vazão e sequencial. Vazão de 0,1 a 1200,0 mL/h programável a intervalos de 0,1 mL/h e controle de volume a infundir de 0,1 a 9999,9 mL. Peso corpóreo máximo 500,0 kg. Limite de concentração de droga: 0,01 a 999,99 mg/mL ou 0,01 a 999,99 µg/mL. Limite de dose de manutenção: 0,01 a 999,99 mg/kg/min ou 0,01 a 999,99 µg/kg/min. Limite de dose inicial: 0,01 a 999,99 µg/kg/min ou 0,01 a 999,99 mg/kg/min. Taxa de KVO ajustável de 0,0 (desabilitado) a 10,0 mL/h. Vazão de Bolus ajustável de 0,2 a 1200,0 mL/h e Volume do Bolus ajustável de 0,5 a 40,0 mL. Possui as seguintes funções: Ajuste de data e hora, macro e micro gotas, volume sonoro, bloqueio de teclado, dados da infusão anterior, ajuste de display, senha do operador, biblioteca de drogas (179 drogas cadastradas e possibilidade de acrescentar 30 drogas CUSTOM), balanço hídrico, ajuste de oclusão, ajuste do sensor de gotas, ajuste do sensor de ar, pré-alarma de fim de infusão com tempo ajustável, ajuste do bolus, ajuste do KVO, ajuste do volume de purga, modo transporte, titulação, reconhecer alarmes, reinicialização de alarmes, zerar volume e programação do volume do frasco. Display com apresentação constante da vazão, barra de progresso da infusão, volume infundido, volume restante (VTBI), tempo restante da infusão, indicador de hora, indicador gráfico de carga da bateria, indicador gráfico de gotejamento real, indicador gráfico e numérico da pressão atual e indicador gráfico de bloqueio de teclado. Possui teclas virtuais com funções rápidas que se alternam de acordo com a necessidade da etapa de programação/infusão. Conta com a opção "Detalhes" durante a infusão para visualização de todas as informações sobre a programação realizada, volume total infundido e os 4 últimos volumes parciais infundidos em todos os modos de programação. Possui sensor de ar na linha ultrassônico ajustável desde alarme imediato para detecção de qualquer bolha de ar, até 500 µL e sensor de pressão ajustável em três níveis: Alto (100 kPa), Médio (60 kPa) e Baixo (30 kPa). Pré-alarmes: fim da bateria, fim da dose inicial (indução), fim da infusão e fim do volume de frasco. Alarmes visuais e sonoros: espera (stand by), vazão livre, KVO, infusão interrompida, oclusão, ar na linha, porta aberta, frasco vazio, infusão completa, bateria baixa, bateria crítica, erro de programação (valor inválido), sentido do fluxo, desconectar paciente, bomba sem equipo, modo transporte (sensor de gotas desabilitado) e sensor de ar desligado. O limite de armazenamento de registros da bomba icatu (ICATU 3ª edição) é de 8.000 eventos, incluindo registros técnicos e de infusão (a quantidade de infusões gravadas varia com a quantidade de eventos utilizados). A bomba vem com bateria recarregável de níquel-metal hidreto de longa vida com autonomia de até 5 horas, cabo de alimentação e manual do usuário no idioma Português. Este modelo possibilita o download dos dados de infusão pelo software SamLOG II através de comunicação por uma porta USB (conectividade) (opcional). Opcionalmente poderá ser fornecida uma haste para soro. Equipamento de pequeno porte, leve, com design inovador e teclado capacitivo de fácil manuseio e limpeza. Este modelo possui uma saída auxiliar para conexão elétrica que permite a interconexão e o empilhamento (em pedestal) recomendado de até 5 bombas de infusão icatu, marca Samtronic. O equipamento conta com um Menu Engenharia Clínica, que permite que o estabelecimento configure ajustes como: troca de idioma, configuração de alarmes e configuração de parâmetros default. Opera em 95 a 240 V~ e frequência de alimentação de 50/60</i>	7.950,00	0,00	79.500,00
---	-------	--	----------	------	-----------

Proposta Comercial


Nº: 6455/Rev. 0

Data: 18/02/2021 - 14:39

Página: 2/4

Hz. Potência máxima consumida 35 VA (1 equipamento) e 175 VA (5 equipamentos interconectados eletricamente). Possui saída para alimentação externa 9 - 12 V (DC). Proteção contra choques elétricos: Equipamento de classe II, IPX2 e parte aplicada de tipo CF. Peso do equipamento 1,86 kg. Dimensões: 168,6 x 193,3 x 190,8 mm (A / L / P).

Uso hospitalar e ambulatorial. Utilizada com equipamentos registrados para serem utilizados em bombas de infusão (registro ANVISA e certificação INMETRO), incluindo a linha de equipamentos Samtronic família AMISET®. Para utilização de equipamentos de outros fabricantes o equipamento deverá ser calibrado por uma Assistência Técnica Autorizada Samtronic.
Registro M.S. 10188530081



Total da Categoria (R\$): 79.500,00

10	79.500,00
TOTAL DOS PRODUTOS (R\$): 79.500,00	

TOTAL DA PROPOSTA (R\$): 79.500,00

PAGAMENTO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS

ENTREGA: EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS

PREMISSAS E OBSERVAÇÕES:

AS INFORMAÇÕES DESCRITAS NESTA PROPOSTA, SÃO DE USO RESTRITO ENTRE A HOMINUM E O CLIENTE ACIMA CITADO, SENDO PROIBIDA A VEICULAÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO A TERCEIROS.

CONDIÇÕES GERAIS:

IPI:		ICMS:	
PIS:		COFINS:	
Validade:	15 DIAS		
Cond. Pgto:	A COMBINAR		
Tipo de Frete:	Por Conta do Cliente	Valor do frete:	
Transportadora:	REUNIDAS TRANSP RODOVIÁRIOS		
Entrega:	ATÉ 10 DIAS	Garantia:	12 (DOZE) MESES
Atenciosamente, Daniela Farias Hominum Comércio de Produtos para Saúde Ltda licitacao@hominum.com.br		Aprovação Assinatura/Carimbo	


HOMINUM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

CNPJ: 05888881000142 - Inscrição Estadual: 254641989


(48) 3247-0555

Av. Adolfo Konder, 231 - Campinas - 88101-400 - São José/SC

www.hominum.com.br

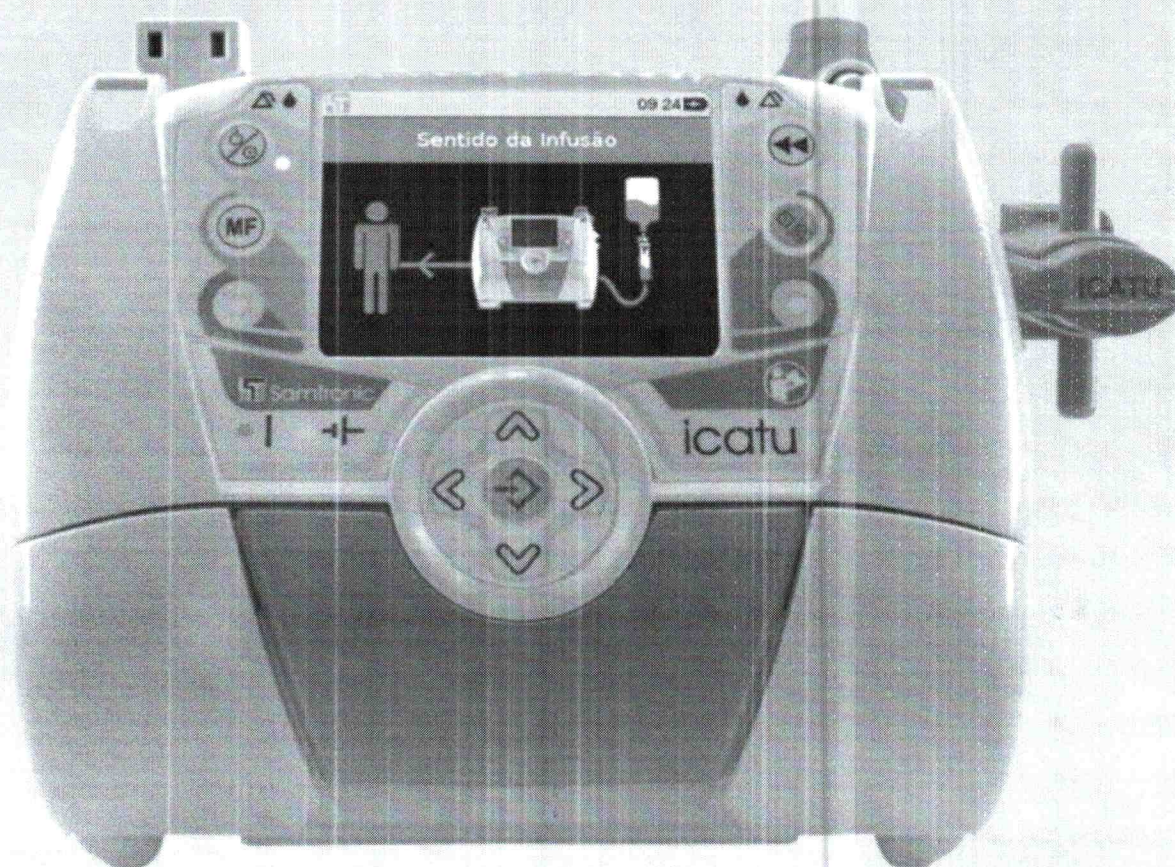

ICATU
BOMBA PERISTÁLTICA LINEAR

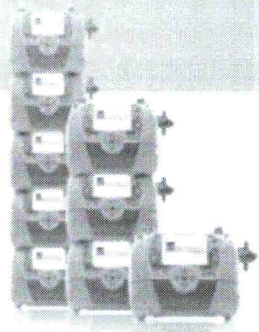

CATU

BOMBA PERISTÁLTICA L NEAR

Leve, compacta, com design atual e recursos inéditos, a nova CATU certamente irá surpreendê-lo. Apresenta um visor colorido LCD de 3.5" que mostra os parâmetros da infusão a partir de uma interface intuitiva e amigável. Oferece ainda a possibilidade de se conectar até cinco equipamentos, alimentados por um único cabo, facilitando a montagem em qualquer suporte. Tudo planejado de forma inteligente e ergonômica. Consulte nossa linha completa de equipamentos AMISET®



Desde 1987, a SAMTRONIC conquistou a sua posição no mercado devido a seu constante investimento em qualidade, pesquisa e desenvolvimento. Possui um rigoroso sistema de gestão que garante a excelência dos produtos e sua equipe de pré e pós-vendas, altamente capacitada, fornece o suporte para a correta aplicação dos seus equipamentos e descartáveis.

Samtronic Indústria e Comércio LTDA - CNPJ: 58.426.628/0001-33
Rua Venda da Esperança, 162 - Bairro Socorro - São Paulo/SP - 04763-040 - Brasil
www.samtronic.com.br | contato.sp@samtronic.com.br | Fone: (11) 2244-7750

www.samtronic.com.br



Sistema de propulsão	• Peristáltico linear
Vazão	• 0,1 a 1200,0 mL/h, incremento de 0,1 mL/h
Volume	• 0,1 a 9999,9 mL
Tempo	• 1 minuto a 999 horas e 59 minutos
Equipo e tempo em uso	• Equipo Samtronic AMISET® por até 96h ou equipo de outros fabricantes*
Protocolos de programação	• Vazão x Volume limite • Tempo x Volume limite • Peso x Concentração x Dose
	• Vazão • Sequencial
Funções especiais	• Titulação • Modo enteral (detector de bolha de ar desabilitado) • Dados da infusão anterior • Zerar volume • Volume de purga • Ajuste de KVO • Ajuste do volume sonoro • Ajuste de bolus • Ajuste de oclusão • Ajuste de sensibilidade do sensor de bolhas de ar • Ajuste de "display" (brilho, contraste e "backlight") • Bloqueio do teclado • Modo transporte • Bloqueio do teclado • Modo transporte • Biblioteca de drogas (com opção de customização) • "Download Log" • Data e hora • Alterar senha do usuário • Ajuste sensor de gotas • Tempo de pré-alarma de fim de infusão • Reconhecer alarme • Reinicializar alarme
Pressão de oclusão	• 3 níveis de ajuste: baixo, médio e alto • Padrão: médio
Detector bolhas de ar	• Sensor ultrassônico, com opção de seleção entre alarme imediato, 50 µL, 150 µL, 250 µL, 500 µL • Valor padrão: 250 µL
Outros recursos de segurança	• Corta fluxo inteligente / automático
KVO	• Programável de 0,1 a 10,0 mL/h • Valor padrão: 5,0 mL/h
Purga	• Vazão: 1200,0 mL/h • Volume: 1 a 20,0 mL
Bolus	• Vazão programável: 0,2 a 1200,0 mL/h • Valor padrão: 1200,0 mL/h • Volume programável: 0,5 a 40,0 mL • Valor padrão: 1,0 mL
Desvio (Erro) da vazão nominal	• ± 5%
Tela	• LCD TFT colorido 3.5"
Conectividade	• USB
Alarmes (prioridades alta, média, baixa e sinal de informação, em conformidade com a ABNT NBR IEC 60601-1-8)	• Desconexão cabo AC • Balanço hídrico • Espera • Funcionamento em modo transporte • Funcionamento em KVO • Vazão livre • Oclusão • Ar na linha • Porta aberta • Frasco vazio (ausência de gotejamento) • Pré-alarma de fim de infusão • Infusão concluída • Infusão interrompida • Fim da dose de indução • Bateria baixa • Bateria crítica • Sentido do fluxo • Desconectar o paciente • Sensor de ar desligado • Sensor de gotas desligado • Final modo transporte • Valor inválido • Erro de mecanismo • Modo bateria • Teclado bloqueado • Erro no "check-up" inicial
Grau contra penetração de líquidos	• IPX2
Interconexão elétrica	• Permite o empilhamento e interconexão elétrica de até 5 bombas Samtronic família KATU
Alimentação elétrica	• 95 ~ 240 V - 50/60 Hz • 9 - 12 V (alimentação externa)
Bateria	• Recarregável NiMH • Autonomia: 5 horas a 25,0 mL/h
Dimensões (L x A x P) / Peso	• 168,6 x 193,3 x 190,8 mm • 1,86 kg
Modo engenharia clínica	• Idioma • Ajuste "display" • Ajuste de volume sonoro mínimo • Senha engenharia clínica • Senha operador • Configuração padrão (possibilidade de alterar os padrões de fábrica das funções): • Volume sonoro • Nível de oclusão • Ar na linha • Ajuste sensor de gotas • Tempo de pré-alarma • Vazão KVO • Bolus • Volume de purga • Identificação
Histórico eventos	• Software SamLOG®

*Equipo para uso em bombas de infusão (consultar especificações no manual de usuário).

As características técnicas podem sofrer alterações sem aviso prévio, dependendo das inovações e melhorias técnicas. Consultar especificações nas instruções de uso. Imagens meramente ilustrativas.



Samtronic



Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Proposta Comercial Nr. 44507

Dados do Cliente:

Fundo Municipal Saude de Chapeco

- 1078

Rua Marechal Floriano Peixoto

CHAPECO

- SC

Att.Sr(a): A/C Jaciara

Fone: (49)3321-0096

CNPJ/CPF 80.636.475/0001-08

Promotor do Setor: Marcos Daniel

Fone: (49)99186-3490

Seq	Descrição	Qtde por CX	Qtde	U.M.	R\$ Unitario	R\$ Total
1	BOMBA DE INFUSAO MI 22 - BIOSENSOR	1	10	UND	7.999,00000	79.990,00
2	VALVULA REGUL.P/ CILINDRO 02 C/ 02 SAIDA - UNITEC	1	6	UND	449,90000	2.699,40
Valor Total da Proposta Comercial (R\$):						82.689,40

Condições Gerais da Proposta:

- 1) O(s) produto(s) acima relacionado(s) pode(rão) sofrer variação em seu(s) saldo(s) de estoque;
- 2) Esta proposta NÃO GARANTE ENTREGA IMEDIATA, é necessário confirmar disponibilidade de estoque no fechamento da compra;
- 3) Conforme RDC Anvisa, NÃO FRACIONAMOS EMBALAGENS, em caso de confirmação atentar-se a quantidade mínima da embalagem;
- 4) O(s) produto(s) será(ão) entregue(s) de acordo com o descrito em nossa Proposta Comercial;
- 5) Condição de Pagamento: 30DD
- 6) Frete: Incluso (Valor mínimo para faturamento R\$ 500,00);
- 7) Prazo Entrega: A Confirmar (necessário confirmar disponibilidade de estoque);
- 8) Validade Proposta: 1 (UM DIA) - Poderão ocorrer alterações de preços sem aviso prévio
- 9) Local e Data da Proposta: Rio do Sul (SC), 18/02/2021

Nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.

Proposta Gerada Por: Marcos

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas

Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil

CNPJ 00.802.002/0001-02

IE: 25.314.899-5

licitacoes@altermed.com.br / altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br

 /Altermed



Jacira Scheren <fincompras5@chapeco.sc.gov.br>

Re: URGENTE - ORÇAMENTO - Altermed - Chapecó

Marcos Daniel | Altermed Material Médico Hospitalar <marcosdaniel@altermed.com.br>
Para: Jacira Scheren <fincompras5@chapeco.sc.gov.br>

18 de fevereiro de 2021, às 10h12

FL: 10

Bom dia,


Conforme solicitado, segue cotação em anexo.

Segue também catálogo da bomba e descritivo abaixo da Válvula.

Em relação aos prazos, a princípio 20 até 30 dias, mas estamos verificando junto ao fabricante se conseguimos diminuir esse prazo.

Caso nossa seja a melhor oferta gostaria de ser informado, pois podemos dar mais atenção nos prazos.

Válvula Reguladora para Cilindro com Duas Saídas

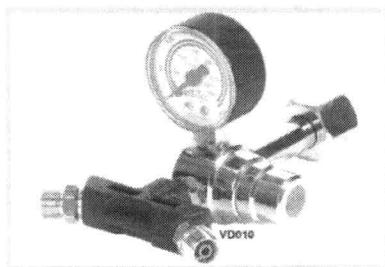


Válvula para regulação da pressão de saída em cilindros de gases medicinais com tomada dupla para acoplagem de aparelhos, permitindo a execução simultânea de diferentes aplicações, como nebulização, oxigenação e aspiração. Sua composição de latão cromado com peças injetadas em nylon garante maior durabilidade ao produto, prolongando a sua vida útil.

Possui manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm², entrada com filtro de bronze sinterizado, válvula de segurança e niples com pino de impacto. Pressão fixa de saída de 3,5 Kgf/cm².

Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906.

ANVISA 10432309004

Catálogo



MARCOS DANIEL DA SILVA
MARCOS DANIEL DA SILVA
REPRESENTANTE

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Estrada Boa Esperança, 2320 | Zip Code: 89.163-554 | Rio do Sul | SC | Brazil
Phone: +55 49 99186 3490
E-mail: marcosdaniel@altermed.com.br



Especificações

Para cilindro de oxigênio

Código

VD010

Antes de imprimir, pense no seu compromisso e responsabilidade com o Meio Ambiente"

Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao(s) destinatário(s) da mensagem. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, queira, por favor, retorná-la ao destinatário e apagá-la de seus arquivos. Qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido. A Altermed Material Médico Hospitalar Ltda não é responsável pelo conteúdo ou a veracidade desta informação."

Às 10:12 de 18/02/2021, Jacira Scheren escreveu:

Bom dia. Solicitamos orçamento de 10 bombas de infusão e 6 válvulas de oxigênio com saída dupla.

Favor especificar prazo de entrega.

Jacira Scheren
(49) 3321-0057
Sesau - Prefeitura de Chapecó/SC

3 anexos

BOMBA DE INFUSÃO MI22.pdf
211K

Orçamento - Altermed - Chapecó - 18-02.PDF
40K

Cartão - Marquinhos.pdf
205K

BOMBA DE INFUSÃO MI22



PARÂMETROS BÁSICOS

Dimensões	132mm X 95mm X 165mm (L*A*P)
Peso	1,33 Kg
Adaptador de energia	entrada A.C. 100V-240V~ 50-60Hz saída D.C. 15V- 2A
Tensão de entrada para a bomba de infusão	D.C.: 15 V
Potência	<20VA
Requisitos para conjunto IV	Consultar seção 11: CUIDADOS AO USAR CONJUNTO DE INFUSÃO DESCARTÁVEL
Taxa de fluxo máxima	2200 ml/h
Anvisa	80393910032

DESEMPENHO PRINCIPAL


Faixa de ajuste da taxa de fluxo:
0,1 - 1-800ml/h (Com a resolução de 1ml/h)
Precisão da taxa de fluxo (desempenho essencial):
± 3%
Faixa de Volume a ser Administrado (VTBI):
0,1-999ml, Com a resolução de 1ml
Precisão do volume de infusão (desempenho essencial):
± 3%
Taxa de purga:
1ml/h~800ml/h ajustável ±20%
Pressão máxima de infusão:
>160kPa
Alarme de oclusão (pressão) (desempenho essencial):
Máximo: 100kPa ±30kPa Mínimo: 40kPa ±20kPa

Tempo para ativação do alarme de oclusão; bolus máximo (desempenho essencial):
Taxa de fluxo mínima: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 40kPa ± 20kPa por 13 minutos ou quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa por 14 segundos. Fluxo intermediário: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa e o bolus produzido é menor ou igual a 0,3 ml. (O conjunto de infusão Jerry é usado para criar oclusão no final da linha de infusão durante o teste de verificação).
Manter a Veia Aberta (KVO)
"Taxa de fluxo 10ml/h Taxa de KVO = 3ml/h;
1ml/h Taxa de fluxo <10ml/h, Taxa de KVO = 1ml/h
Taxa de fluxo <1ml/h, Taxa de KVO = Taxa de fluxo"

Tempo de recuperação depois que o som do alarme for pausado:
1min50s a 2min
Tempo para pausa de alarme:
1min50s a 2min

Alarme de alta prioridade (desempenho essencial):
Alarme de porta aberta (door open alarm), alarme de oclusão (occlusion alarm), alarme de término de volume a ser administrado (VTBI completion alarm), alarme de ar na linha (air in line alarm), alarme de bateria fraca (out of battery alarm), alarme de desconexão dupla de bateria/energia (battery/mains power double disconnect alarm), alarme de mau funcionamento (malfunction alarm).

Classificação:
Classe II Tipo CF, bomba de infusão com fonte de energia interna para operação contínua, IPX2
Requisitos de ambiente:
"Temperatura para armazenamento:
-20°C~+60°C;
Temperatura para operação:
5°C~+40°C"
Tempo de vida útil:
5 anos

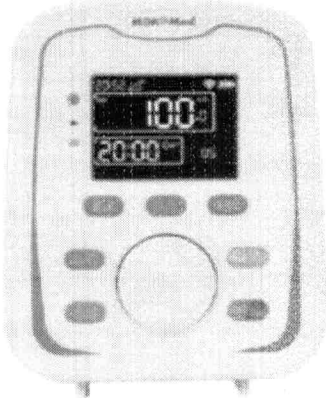

FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS E MAIS FREQUENTES

- Defina a taxa de fluxo de infusão, defina VTBI e exiba dados em tempo real.
- Exiba o volume já infundido.
- Purgar/bolus
- Alarme
- Altere automaticamente a taxa de fluxo para KVO após o alarme de infusão concluída;
- Silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do alarme.
- Exiba o Volume a ser Administrado (VTBI).
- Limpe os dados de VTBI.
- Suporte a várias marcas de conjuntos de infusão;
- Bateria interna.
- Adaptador DC externo.
- Conectividade sem fio WiFi.





BR CIRÚRGICA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR
Fernando R. De Oliveira Cirúrgica - Me
Rua Vergueiro, 6112 - 6116
Alto do Ipiranga - São Paulo - SP - CEP: 04272100
Fone: (11) 2924-9414 - (11) 2924-9412 / WhatsApp (11) 94724-8392
Site: www.brcirurgica.com.br
E-mail: vendas@brcirurgica.com.br
C.N.P.J.: 36.668.603/0001-03
INSCR. EST.: 567.895.899.855

Orçamento Nº: 18451

Vendedor: VENDAS1

Data: 18/02/2021

Status: Aguardando Confirmação

Validade até: 18/02/2021



Cliente:

Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO
Nome / Razão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO**
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto - 700L - CEP: Centro
C.N.P.J./C.P.F.: 80.636.475/0001-08 - INSC. EST. / RG:

Contato:

Nome: **JACIARA**
Telefone: (49) 3319-1415
Celular:
E-mail: gae@chapeco.sc.gov.br
Site:

Cód.

Descrição do Produto

Val. Un.

Qt.

Val. Total

VD010 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM DUAS SAÍDAS


Válvula para regulação da pressão de saída em cilindros de gases medicinais com tomada dupla para acoplagem de aparelhos, permitindo a execução simultânea de diferentes aplicações, como nebulização, oxigenação e aspiração. Sua composição de latão cromado com peças injetadas em nylon garante maior durabilidade ao produto, prolongando a sua vida útil. Possui manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm², entrada com filtro de bronze sinterizado, válvula de segurança e niples com pino de impacto. Pressão fixa de saída de 3,5 Kgf/cm². Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906.

R\$
575,00

6

R\$
3.450,00

74194585



Cód.

Descrição do Produto

Val. Un.

Qt.

Val. Total

YONAH - BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA

A Bomba de Infusão Yonah da CMOS DRAKE é portátil e versátil. Com tela Touch Screen de 4,3", ela possui sistema de encaixe inteligente que permite empilhamento de várias bombas num mesmo suporte. É a solução com tecnologia e segurança para tratamento com equipo universal para medicação, dieta enteral e parenteral. Possibilita uso adulto, pediátrico e neonatal, usada para controlar a dose de líquido infundido no corpo do paciente com controle preciso das gotas e transporte seguro de fluidos de drogas na veia do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa. Essa versátil bomba de infusão possibilita vários modos de programação, de infusão e recursos de customização, além de funções de registros de históricos, biblioteca de medicamentos, anti-bolus e diversos alarmes. BATERIA lítio 11.1V 2600mAh - Tempo de carregamento: 5h - Tempo de trabalho: 9h Alimentação Fonte de rede: 100V - 240 V 50/60Hz - Fonte de alimentação: DC 15 V - Potência de entrada: 50 VA Segurança Tipo de proteção classe I Proteção contra entrada de fluidos IP24 Proteção aplicada tipo CF a prova de desfibrilação Modo de trabalho Operação contínua Dimensões 233,5 x 99 x 120mm COMUNICAÇÃO Porta USB, Auto Falante, Por Infra Vermelho Aparelhos de infusão 10-60 gotas/ml Precisão do Sistema $\pm 1 \text{ ml/h}$, $\pm 5\%$

74410074

R\$
8.395,00

10

R\$
83.950,00**TOTAL GERAL: R\$ 87.400,00**

Frete Orçado: Cortesia

Resumo Geral da Proposta**Formas de Pagamentos**

Antecipado com Desconto Boleto, Transferência ou Depósito.

Banco	Agência	Conta
BRADESCO	2184-9	37388-5
BRASIL	3131-3	200.270-1
ITAÚ	0333	19412-4
SANTANDER	0666	130037936

R\$ 87.400,00

***Faturado**

R\$ 87.400,00

FATURAMENTO LIBERADO APÓS ANÁLISE FINANCEIRA.

Mediante análise financeira e após a primeira compra.

Parcelamento Nos Cartões

VISA



Hipercard



R\$ 87.400,00

EM ATÉ X de R\$ 0,00



**** Os Valores e Condições Deste Orçamento Serão Válidos Até 26/02/2021 ****

Prazo de Entrega: 25 DIAS UTEIS A CONTAR DA COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO

(Os Produtos poderão ser entregues antes da data de prevista)

Prezado cliente não trabalhamos com licitação! Após análise financeira verificaremos a possibilidade de CARTA EMPENHO Junto ao departamento Responsável. LER ATENTAMENTE. Cotação referente os itens citados acima, Atenderemos apenas informações que esta neste conteúdo! Conferir para que não haja divergências. Lembrando que orçamento que é autorizado faturamento, título é negociado com Factoring que realiza o controle de nossos vencimento. Br Cirúrgica Cuidando da sua Saúde. Agradecemos desde já!

Cotação Elaborada Pelo(a) Consultor(a) **VENDAS1**



BR CIRÚRGICA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR


Agradecemos a Preferência!

Sesau - Prefeitura de Chapecó/SC

A/C: Jaciara Scheren

(49) 3321-0057 fincompras5@chapeco.sc.gov.br

ORÇAMENTO

Item	Quant	Unid	Descrição	Valor Unit	Valor Total
1	10	Unid	BOMBA DE INFUSÃO YONAH 	10.350,00	103.500,00
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PORTÁTIL 4,3" TOUCH SCREEN - APENAS 1.8 KG Uso adulto, pediátrico e neonatal. Equipo universal para medicação e dieta parenteral universal, Funções de registros de históricos, biblioteca de medicamentos, anti-bolus e diversos alarmes. Vários modos de programação, de infusão e recursos de customização. Bateria 9H DE DURAÇÃO AUTOTESTE AUTOMÁTICO AO LIGAR					

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 7 DIAS APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS

Chapecó SC, 18 de Fevereiro de 2021

Item	Quant	Unid	Descrição	Valor Unit	Valor Total
1	6	Unid	VALVULA REDUT.CILINDRO OXIG. 2 SAIDAS	367,50	2.205,00
2	6	Unid	VALVULA REDUT.CILINDRO OXIG. 1 SAIDAS	285,00	1.710,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS


PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 20 DIAS APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO

Chapecó SC, 18 de Fevereiro de 2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.888.881/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/09/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOMINUM COMERCIO	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV GOVERNADOR ADOLFO KONDER	NÚMERO 231	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 88.101-400	BAIRRO/DISTRITO CAMPINAS	MUNICÍPIO SAO JOSE	UF SC
-------------------	-----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@HOMINUM.COM.BR	TELEFONE (48) 3247-0555
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/09/2003
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/02/2021 às 08:57:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

FILTROS APLICADOS:


CPF / CNPJ: 05888881000142

Data da consulta: 23/02/2021 08:04:00
Data da última atualização: 22/02/2021 18:00:09

LIMPAR

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/02/2021 às 09:00) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 05.888.881/0001-42.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6034.EE69.CF11.B641 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 05888881000142

Data da consulta: 23/02/2021 07:53:17
Data da última atualização: 22/02/2021 18:00:09

LIMPAR

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.888.881/0001-42

Certidão nº: 6924828/2021

Expedição: 23/02/2021, às 09:01:05

Validade: 21/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.888.881/0001-42**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.888.881/0001-42

Razão Social: HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP

Endereço: AV GOVERNADOR ADOLFO KONDER 231 / CAMPINAS / SAO JOSE / SC /
88101-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/02/2021 a 23/03/2021

Certificação Número: 2021022200360950308550

Informação obtida em 23/02/2021 09:02:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ/CPI: 05.888.881/0001-42


Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	210140010419028
Data de emissão:	25/01/2021 14:21:53
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.):	26/03/2021

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 05.888.881/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:06:35 do dia 11/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/08/2021.

Código de controle da certidão: **ECC1.DA29.A58A.0E5C**


Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DA RECEITA

Data: 23/02/2021 13h00min

Número	Validade
11898	24/05/2021



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP CNPJ: 05888881000142

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Econômico: 308153 - Atividade principal: COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO
Endereço: GOV ADOLFO KONDER, 231 - Bairro Campinas - CEP 88.101-400

Código de Controle

CWU72G9E73BEVFG1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.pmsj.sc.gov.br>

São José (SC), 23 de Fevereiro de 2021

Rua Acloni Souza Filho - Beira Mar São José, 403 - Praia Comprida
São José (SC) - CEP: 88103790 - Fone: 4833810000



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ



DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2021-FMS

OBJETO:

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BOMBAS DE INFUSÃO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 h.

FORNECEDOR:

HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

QUANTIDADE: 5 (cinco) unidades

VALOR DA DISPENSA: R\$ 39.750,00 (trinta e nove mil setecentos e cinquenta reais), correspondendo a R\$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta reais) por equipamento.

FUNDAMENTO LEGAL:

Art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores:

[...]

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

JUSTIFICATIVA:

Com o aumento de casos positivos da Covid 19, combinado com a superlotação do Hospital Regional do Oeste, muitos pacientes tem permanecido na Unidade de Pronto Atendimento do Município.

A permanência dos pacientes na Unidade fez aumentar a administração de medicação por via endovenosa, fazendo que as bombas de infusão a disposição do serviço tornem-se insuficientes para atender a demanda.

Desse modo, para que não haja prejuízo no tratamento dos pacientes torna-se imprescindível a aquisição dos equipamentos.

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CHAPECÓ



Dentre os orçamentos realizados os fornecedores selecionados foram os que apresentaram os orçamentos com os menores valores.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

Menores valores dentre as propostas de preços recebidas.

Chapecó - SC, 22 de fevereiro de 2021.

RIQUELMO BEDIN FILHO

Presidente da Comissão Municipal de Licitações

Em virtude da exposição referente à realização da despesa independente de Licitação, fundamentado nos motivos acima, e de conformidade com a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações:

HOMOLOGO A REALIZAÇÃO DA PRESENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Chapecó – SC, 22 de fevereiro de 2021.

LUIZ CARLOS BALSAN

Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
Procuradoria-Geral do Município



Chapecó-SC, 24 de fevereiro de 2021.

PARECER JURÍDICO Nº 0234/20210

OBJETO: Minuta de Dispensa de Licitação nº 016/2021-FMS. Análise Jurídica-Formal. Aquisição emergencial de bombas de infusão.

Trata-se o presente de análise da minuta da Dispensa de Licitação nº 16/2021-FMS, por intermédio do qual se pretende a aquisição emergencial de bombas de infusão para Unidade de Pronto Atendimento 24 horas.

Constam nos autos analisados, além da minuta objeto deste parecer: Solicitação de Compra/Contratação nº 435/202, assinada pelo Secretário de Saúde e pelo Diretor de Administração, Finanças e Infraestrutura, instruído com proposta comercial e demais documentos.

No que concerne ao processo ora analisado, a autoridade competente informa que o fundamento legal da dispensa é aquele disposto no inciso X do art. 24 da Lei Federal n. 8.666/1993:

Art. 24. É dispensável a licitação:


[...] IV – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

DECRETO MUNICIPAL Nº 38.52/20

Art. 4º Fica autorizada a realização de despesas, inclusive com dispensa de licitação, para o cumprimento deste Decreto, tais como a



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
Procuradoria-Geral do Município



contratação de profissionais da área da saúde, na hipótese de necessidade emergencial, e a aquisição de medicamentos, leitos de UTI e outros insumos, mediante prévia justificativa da área competente ratificada por ato da Secretaria Municipal de Saúde. Parágrafo único. Na contratação de bens ou serviços para tratamento, prevenção isolamento ou quarentena, em caso de dispensa de licitação, a Secretaria Municipal de Saúde deverá observar as hipóteses previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como instruir o processo com justificativa e parecer jurídico emitidos pela Procuradoria Geral do Município.

Conforme se denota do processo de dispensa, a autoridade competente justifica a aquisição tendo em vista que:

O Com o aumento de casos positivos da Covid 19, combinado com a superlotação do Hospital Regional do Oeste, muitos pacientes tem permanecido na Unidade de Pronto Atendimento do Município.

A permanência dos pacientes na Unidade fez aumentar a administração de medicação por via endovenosa, fazendo que as bombas de infusão a disposição do serviço tornem-se insuficientes para atender a demanda.

Desse modo, para que não haja prejuízo no tratamento dos pacientes torna-se imprescindível a aquisição dos equipamentos.

Quanto à razão da escolha dos fornecedores, foi salientado pela autoridade competente:

Dentre os orçamentos realizados os fornecedores selecionados foram os que apresentaram os orçamentos com os menores valores.


No quesito preço, tem-se que são os "menores valores dentre as propostas de preços recebidas".

Neste sentido, resta claro que o processo ora em análise está devidamente amparado na legislação específica para o caso em tela, qual seja, Lei Federal n. 8.666.93.

Diante do exposto esta Procuradoria manifesta-se pela viabilidade jurídica da realização da Dispensa de Licitação nº 16/2021-FMS.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
Procuradoria-Geral do Município



Por derradeiro, cumpre salientar que o presente parecer baseia-se nos elementos que constam até a presente data nos autos ora analisados e a análise *supra* se dá sob o prisma estritamente jurídico, não competindo-nos adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados pelos demais órgãos da Administração Municipal, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

É o parecer¹.

Lucas Baldo
Consultor Jurídico
OAB/SC nº 55.014

¹ O parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da administração pública não é ato administrativo, sendo apenas a opinião técnico-jurídica emitida pelo operador do direito, que orientará o administrador na tomada da decisão, ou seja, na prática do ato administrativo que se constitui na execução *ex officio* da lei na oportunidade do julgamento, porquanto, o parecer jurídico constitui-se ato opinativo que pode, ou não, ser considerado pelo administrador (MS-24584/DF).



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>

Usuário: Maiera dos Santos

Chave de Autenticação Digital
1396-6006-008

Página:
1 / 1

Licitações Adjudicadas

Licitação: 16/2021 **Modalidade:** Dispensa por Justificativa **Julgamento:** Por item **Registro de preço:** Não **Controla quantidade:** Sim
Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BOMBAS DE INFUSÃO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

Fornecedor: 10419 - HOMINUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 05.888.881/0001-42

Valor total (R\$):

39.750,00

Data	Item	Material/Serviço/Denominação	Un. Medida	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
22/02/2021	1	191194 - BOMBA DE INFUSÃO	UNIDADE	5,00000	7.950,00000	39.750,00

Complemento do item:

Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear, marca SAMTRONIC, modelo icatu, de fabricação nacional, para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável. Utiliza descartável micro e macrogotas destinados a serem utilizados em bombas de infusão que estejam de acordo com as seguintes características: tubo de PVC de diâmetro interno 3,1mm e diâmetro externo 4,2mm e dureza entre 65 a 70 Shore A. Sistema de propulsão peristáltico linear. Desvio da vazão com equipo padrão de $\pm 5\%$ da vazão programada (típico). Possui cinco tipos de programação de infusão: mL/h x volume limite, tempo x volume limite, peso x concentração x dose (com opção de programação do bolus por volume ou por dose), vazão e sequencial. Vazão de 0,1 a 1200,0 mL/h programável a intervalos de 0,1 mL/h e controle de volume a infundir de 0,1 a 9999,9 mL. Peso corpóreo máximo 500,0 kg. Limite de concentração de droga: 0,01 a 999,99 mg/mL ou 0,01 a 999,99 μ g/mL. Limite de dose de manutenção: 0,01 a 999,99 mg/kg/min ou 0,01 a 999,99 μ g/kg/min. Limite de dose inicial: 0,01 a 999,99 μ g/kg/min ou 0,01 a 999,99 mg/kg/min. Taxa de KVO ajustável de 0,0 (desabilitado) a 10,0 mL/h. Vazão de Bolus ajustável de 0,2 a 1200,0 mL/h e Volume do Bolus ajustável de 0,5 a 40,0 mL. Possui as seguintes funções: Ajuste de data e hora, macro e micro gotas, volume sonoro, bloqueio de teclado, dados da infusão anterior, ajuste de display, senha do operador, biblioteca de drogas (179 drogas cadastradas e possibilidade de acrescentar 30 drogas CUSTOM), balanço hídrico, ajuste de oclusão, ajuste do sensor de gotas, ajuste do sensor de ar, pré-alarma de fim de infusão com tempo ajustável, ajuste do bolus, ajuste do KVO, ajuste do volume de purga, modo transporte, titulação, reconhecer alarmes, reinicialização de alarmes, zerar volume e programação do volume do frasco. Display com apresentação constante da vazão, barra de progresso da infusão, volume infundido, volume restante (VTBI), tempo restante da infusão, indicador de hora, indicador gráfico de carga da bateria, indicador gráfico de gotejamento real, indicador gráfico e numérico da pressão atual e indicador gráfico de bloqueio de teclado. Possui teclas virtuais com funções rápidas que se alternam de acordo com a necessidade da etapa de programação/infusão. Conta com a opção *Detalhes* durante a infusão para visualização de todas as informações sobre a programação realizada, volume total infundido e os 4 últimos volumes parciais infundidos em todos os modos de programação. Possui sensor de ar na linha ultrassônico ajustável desde alarme imediato para detecção de qualquer bolha de ar, até 500 μ L e sensor de pressão ajustável em três níveis: Alto (100 kPa), Médio (60 kPa) e Baixo (30 kPa). Pré-alarmes: fim da bateria, fim da dose inicial (indução), fim da infusão e fim do volume de frasco. Alarmes visuais e sonoros: espera (stand by), vazão livre, KVO, infusão interrompida, oclusão, ar na linha, porta aberta, frasco vazio, infusão completa, bateria baixa, bateria crítica, erro de programação (valor inválido), sentido do fluxo, desconectar paciente, bomba sem equipo, modo transporte (sensor de gotas desabilitado) e sensor de ar desligado. O limite de armazenamento de registros da bomba icatu (ICATU 3a edição) é de 8.000 eventos, incluindo registros técnicos e de infusão (a quantidade de infusões gravadas varia com a quantidade de eventos utilizados). A bomba vem com bateria recarregável de níquel-metal hidreto de longa vida com autonomia de até 5 horas, cabo de alimentação e manual do usuário no idioma Português. Este modelo possibilita o download dos dados de infusão pelo software SamLOG II através de comunicação por uma porta USB (conectividade) (opcional). Opcionalmente poderá ser fornecida uma haste para soro. Equipamento de pequeno porte, leve, com design inovador e teclado capacitivo de fácil manuseio e limpeza.

Total Adjudicado (R\$):

39.750,00

Total de licitações adjudicadas: 1

Total Geral Adjudicado (R\$):

39.750,00



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Maiara dos Santos

Chave de Autenticação Digital
1730-2536-490

Página
1 / 1

Licitações homologadas

Licitação: 16/2021

Modalidade: Dispensa por Justificativa

Registro de preço: Não

Controla quantidade: Sim

95

Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BOMBAS DE INFUSÃO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

Credor/Fornecedor: 10419-HOMINUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Data	Item	Un. Medida	Material/Serviço/Denominação
------	------	------------	------------------------------

23/02/2021	1	UNIDADE	191194 - BOMBA DE INFUSÃO
------------	---	---------	---------------------------

Complemento do item: Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear, marca SAMTRONIC, modelo icatu, de fabricação nacional, para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável. Utiliza descartável micro e macrogotas destinados a serem utilizados em bombas de infusão que estejam de acordo com as seguintes características: tubo de PVC de diâmetro interno 3,1mm e diâmetro externo 4,2mm e dureza entre 65 a 70 Shore A. Sistema de propulsão peristáltico linear. Desvio da vazão com equipo padrão de $\pm 5\%$ da vazão programada (típico). Possui cinco tipos de programação de infusão: mL/h x volume limite, tempo x volume limite, peso x concentração x dose (com opção de programação do bolus por volume ou por dose), vazão e sequencial. Vazão de 0,1 a 1200,0 mL/h programável a intervalos de 0,1 mL/h e controle de volume a infundir de 0,1 a 9999,9 mL. Peso corpóreo máximo 500,0 kg. Limite de concentração de droga: 0,01 a 999,99 mg/mL ou 0,01 a 999,99 μ g/mL. Limite de dose de manutenção: 0,01 a 999,99 mg/kg/min ou 0,01 a 999,99 μ g/kg/min. Limite de dose inicial: 0,01 a 999,99 μ g/kg/min ou 0,01 a 999,99 mg/kg/min. Taxa de KVO ajustável de 0,0 (desabilitado) a 10,0 mL/h. Vazão de Bolus ajustável de 0,2 a 1200,0 mL/h e Volume do Bolus ajustável de 0,5 a 40,0 mL. Possui as seguintes funções: Ajuste de data e hora, macro e micro gotas, volume sonoro, bloqueio de teclado, dados da infusão anterior, ajuste de display, senha do operador, biblioteca de drogas (179 drogas cadastradas e possibilidade de acrescentar 30 drogas CUSTOM), balanço hídrico, ajuste de oclusão, ajuste do sensor de gotas, ajuste do sensor de ar, pré-alarme de fim de infusão com tempo ajustável, ajuste do bolus, ajuste do KVO, ajuste do volume de purga, modo transporte, titulação, reconhecer alarmes, reinicialização de alarmes, zerar volume e programação do volume do frasco. Display com apresentação constante da vazão, barra de progresso da infusão, volume infundido, volume restante (VTBI), tempo restante da infusão, indicador de hora, indicador gráfico de carga da bateria, indicador gráfico de gotejamento real, indicador gráfico e numérico da pressão atual e indicador gráfico de bloqueio de teclado. Possui teclas virtuais com funções rápidas que se alternam de acordo com a necessidade da etapa de programação/infusão. Conta com a opção *Detalhes* durante a infusão para visualização de todas as informações sobre a programação realizada, volume total infundido e os 4 últimos volumes parciais infundidos em todos os modos de programação. Possui sensor de ar na linha ultrassônico ajustável desde alarme imediato para detecção de qualquer bolha de ar, até 500 μ L e sensor de pressão ajustável em três níveis: Alto (100 kPa), Médio (60 kPa) e Baixo (30 kPa). Pré-alarmes: fim da bateria, fim da dose inicial (indução), fim da infusão e fim do volume de frasco. Alarmes visuais e sonoros: espera (stand by), vazão livre, KVO, infusão interrompida, oclusão, ar na linha, porta aberta, frasco vazio, infusão completa, bateria baixa, bateria crítica, erro de programação (valor inválido), sentido do fluxo, desconectar paciente, bomba sem equipo, modo transporte (sensor de gotas desabilitado) e sensor de ar desligado. O limite de armazenamento de registros da bomba icatu (ICATU 3a edição) é de 8.000 eventos, incluindo registros técnicos e de infusão (a quantidade de infusões gravadas varia com a quantidade de eventos utilizados). A bomba vem com bateria recarregável de níquel-metal hidreto de longa vida com autonomia de até 5 horas, cabo de alimentação e manual do usuário no idioma Português. Este modelo possibilita o download dos dados de infusão pelo software SamLOG II através de comunicação por uma porta USB (conectividade) (opcional). Opcionalmente poderá ser fornecida uma haste para soro. Equipamento de pequeno porte, leve, com design inovador e teclado capacitivo de fácil manuseio e limpeza.

Total licitações homologadas: 1

Campanha de entidades empresariais apresenta balanço

Doações de qualquer valor podem ser feitas por empresas e pessoas físicas

Três dias após lançar uma campanha emergencial de apoio às ações do poder público em decorrência do expressivo aumento de casos e mortes pelo coronavírus, o Centro Empresarial de Chapecó (CEC) apresentou uma prévia dos encaminhamentos até esta quarta-feira, 24 de fevereiro. Foram indicados os recursos levantados na campanha "SOS Chapecó e Região" e as iniciativas voltadas para contribuir com medidas que a administração pública, devido a exigências legais, nem sempre pode providenciar de forma ágil.

Uma das definições compreende a destinação de parte do que for arrecadado para a montagem de ambulatório emergencial

no Centro de Eventos Plínio Arlindo De Nes. Foi mantido contato com o secretário Municipal da Saúde, Luiz Carlos Balsan, para a indicação das necessidades materiais, de forma que o Centro Empresarial possa participar da compra diretamente. Nesse sentido, o presidente do CEC, Cidnei Luiz Barozzi, indica que será formado um grupo especial para tratar do assunto. Além disso, foi decidido, com o presidente do Observatório Social de Chapecó, Mário Miranda, que essa instituição fará o acompanhamento do respectivo fluxo, ou seja, aquisição, entrega e conferência.

No primeiro balanço prévio divulgado na tarde desta quarta-feira, até às 15h50

já havia a doação de recursos da ordem de R\$ 320.415,39. São originários das 16 entidades e sindicatos empresariais que fazem parte do CEC, bem como de empresas dos respectivos setores, fornecedores e pessoas físicas.

Doações de qualquer valor podem ser feitas por empresas e pessoas físicas, por meio do Scred (748), agência 0258, conta corrente 71014-8, PIX 73211385000100, C N P J 73.211.385/0001-00 (Centro Empresarial). Também pode ser utilizado para doações o Sicoob (756), agência 3069, conta corrente 275.540-8, PIX 49984222332, igualmente em nome do Centro Empresarial de Chapecó.

Ministério da Saúde libera 18 profissionais para Chapecó e Centro de Eventos terá 30 leitos

Um dia após reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o João Rodrigues recebeu a informação de que o Governo Federal vai disponibilizar 18 profissionais da saúde a partir da próxima sexta-feira, dia 26. No gabinete do deputado federal Ricardo Guidi (PSD), acompanhado do secretário de Governo, Thiago Felipe Etges, o prefeito fez um vídeo anunciando


a boa notícia.

"Duas excelentes notícias, conseguimos a confirmação do primeiro pleito já sendo atendido, o Ministério da Saúde esta determinando o deslocamento de seis enfermeiros, dez técnicos de enfermagem e dois fisioterapeutas. Eles também estão tentando atender os demais pedidos, como médicos. Com isso vamos ampliar o atendimento do am-

bulatório Covid, numa sala que está sendo montada, com 30 leitos no Centro de Eventos", disse o prefeito.

Os demais pedidos encaminhados ao ministro são doses extras de vacinas, equipamentos hospitalares, insumos e medicamentos. O prefeito também solicitou a contratação de profissionais de saúde com graduação em outros países.

Divulgação/Extra Comunica

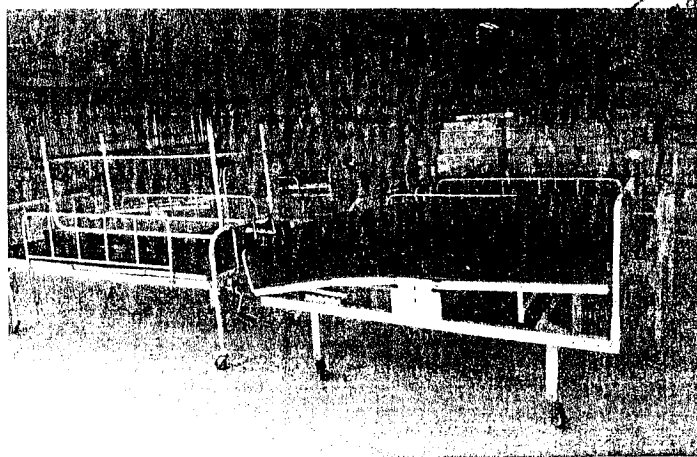

Uma das definições compreende a destinação de parte do que for arrecadado para a montagem de ambulatório emergencial no Centro de Eventos Plínio Arlindo De Nes

<p>MUNICÍPIO DE CHAPECÓ-SC Dispensa de Licitação nº. 02/2021-FMAS Objeto: Serviço de hospedagem para usuários da assistência social em situação de rua que estão em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da COVID-19. Contratada: PAULA DALLA CORTE EIRELI (STAR HOTEL) Valor da dispensa: R\$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) Fundamentação legal: art. 24, inciso IV, da lei 8.666/93. CHAPECÓ, 23 de fevereiro de 2021.</p> <p>ELISIANI SCHMIDT SANCHES Secretária de Assistência Social</p>
<p>MUNICÍPIO DE CHAPECÓ-SC Dispensa de Licitação nº. 13/2021-FMS Objeto: Aquisição emergencial de camas hospitalares para atender demanda da Unidade de Pronto Atendimento decorrente da Covid-19. Contratada: FERRARO EXCLUSIVE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Valor: R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) por cama hospitalar (incluindo o colchão), perfazendo R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Fundamentação legal: art. 24, inciso IV, da lei 8.666/93 e alterações posteriores. CHAPECÓ, 23 de fevereiro de 2021.</p> <p>LUIZ CARLOS BALSAN Secretário de Saúde</p>
<p>MUNICÍPIO DE CHAPECÓ-SC Dispensa de Licitação nº. 14/2021-FMS Objeto: Aquisição emergencial de medicamentos para intubação e manutenção de pacientes com Covid-19. Fornecedores: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ALTERMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA Valor da dispensa: R\$ 47.046,60 (quarenta e sete mil e quarenta e seis reais e sessenta centavos). Fundamentação legal: art. 24, inciso IV, da lei 8.666/93. CHAPECÓ, 23 de fevereiro de 2021.</p> <p>LUIZ CARLOS BALSAN Secretário de Saúde</p>
<p>MUNICÍPIO DE CHAPECÓ-SC Dispensa de Licitação nº. 15/2021-FMS Objeto: Aquisição emergencial de medicamentos a serem utilizados no tratamento de sintomas respiratórios. Fornecedores: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor da dispensa: R\$ 77.782,00 (setenta e sete mil setecentos e oitenta e dois reais) Fundamentação legal: art. 24, inciso IV, da lei 8.666/93. CHAPECÓ, 23 de fevereiro de 2021.</p> <p>LUIZ CARLOS BALSAN Secretário de Saúde</p>
<p>MUNICÍPIO DE CHAPECÓ-SC Dispensa de Licitação nº. 16/2021-FMS Objeto: Aquisição emergencial de bombas de infusão para a Unidade de Pronto Atendimento. Fornecedor: HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Valor da dispensa: R\$ 7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta) perfazendo R\$ 39.750,00 (trinta e nove mil setecentos e cinquenta reais). Fundamentação legal: art. 24, inciso IV, da lei 8.666/93. CHAPECÓ, 23 de fevereiro de 2021.</p> <p>LUIZ CARLOS BALSAN Secretário de Saúde</p>